



CAJA DISPENSADORA M

MICROCANAL E



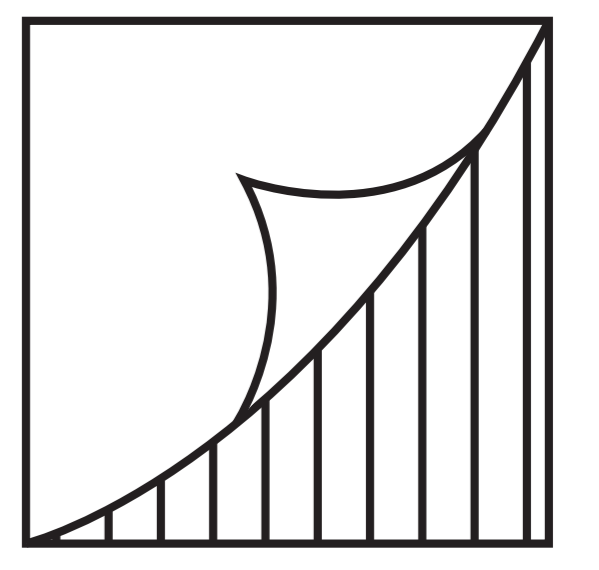


Dirección de canal

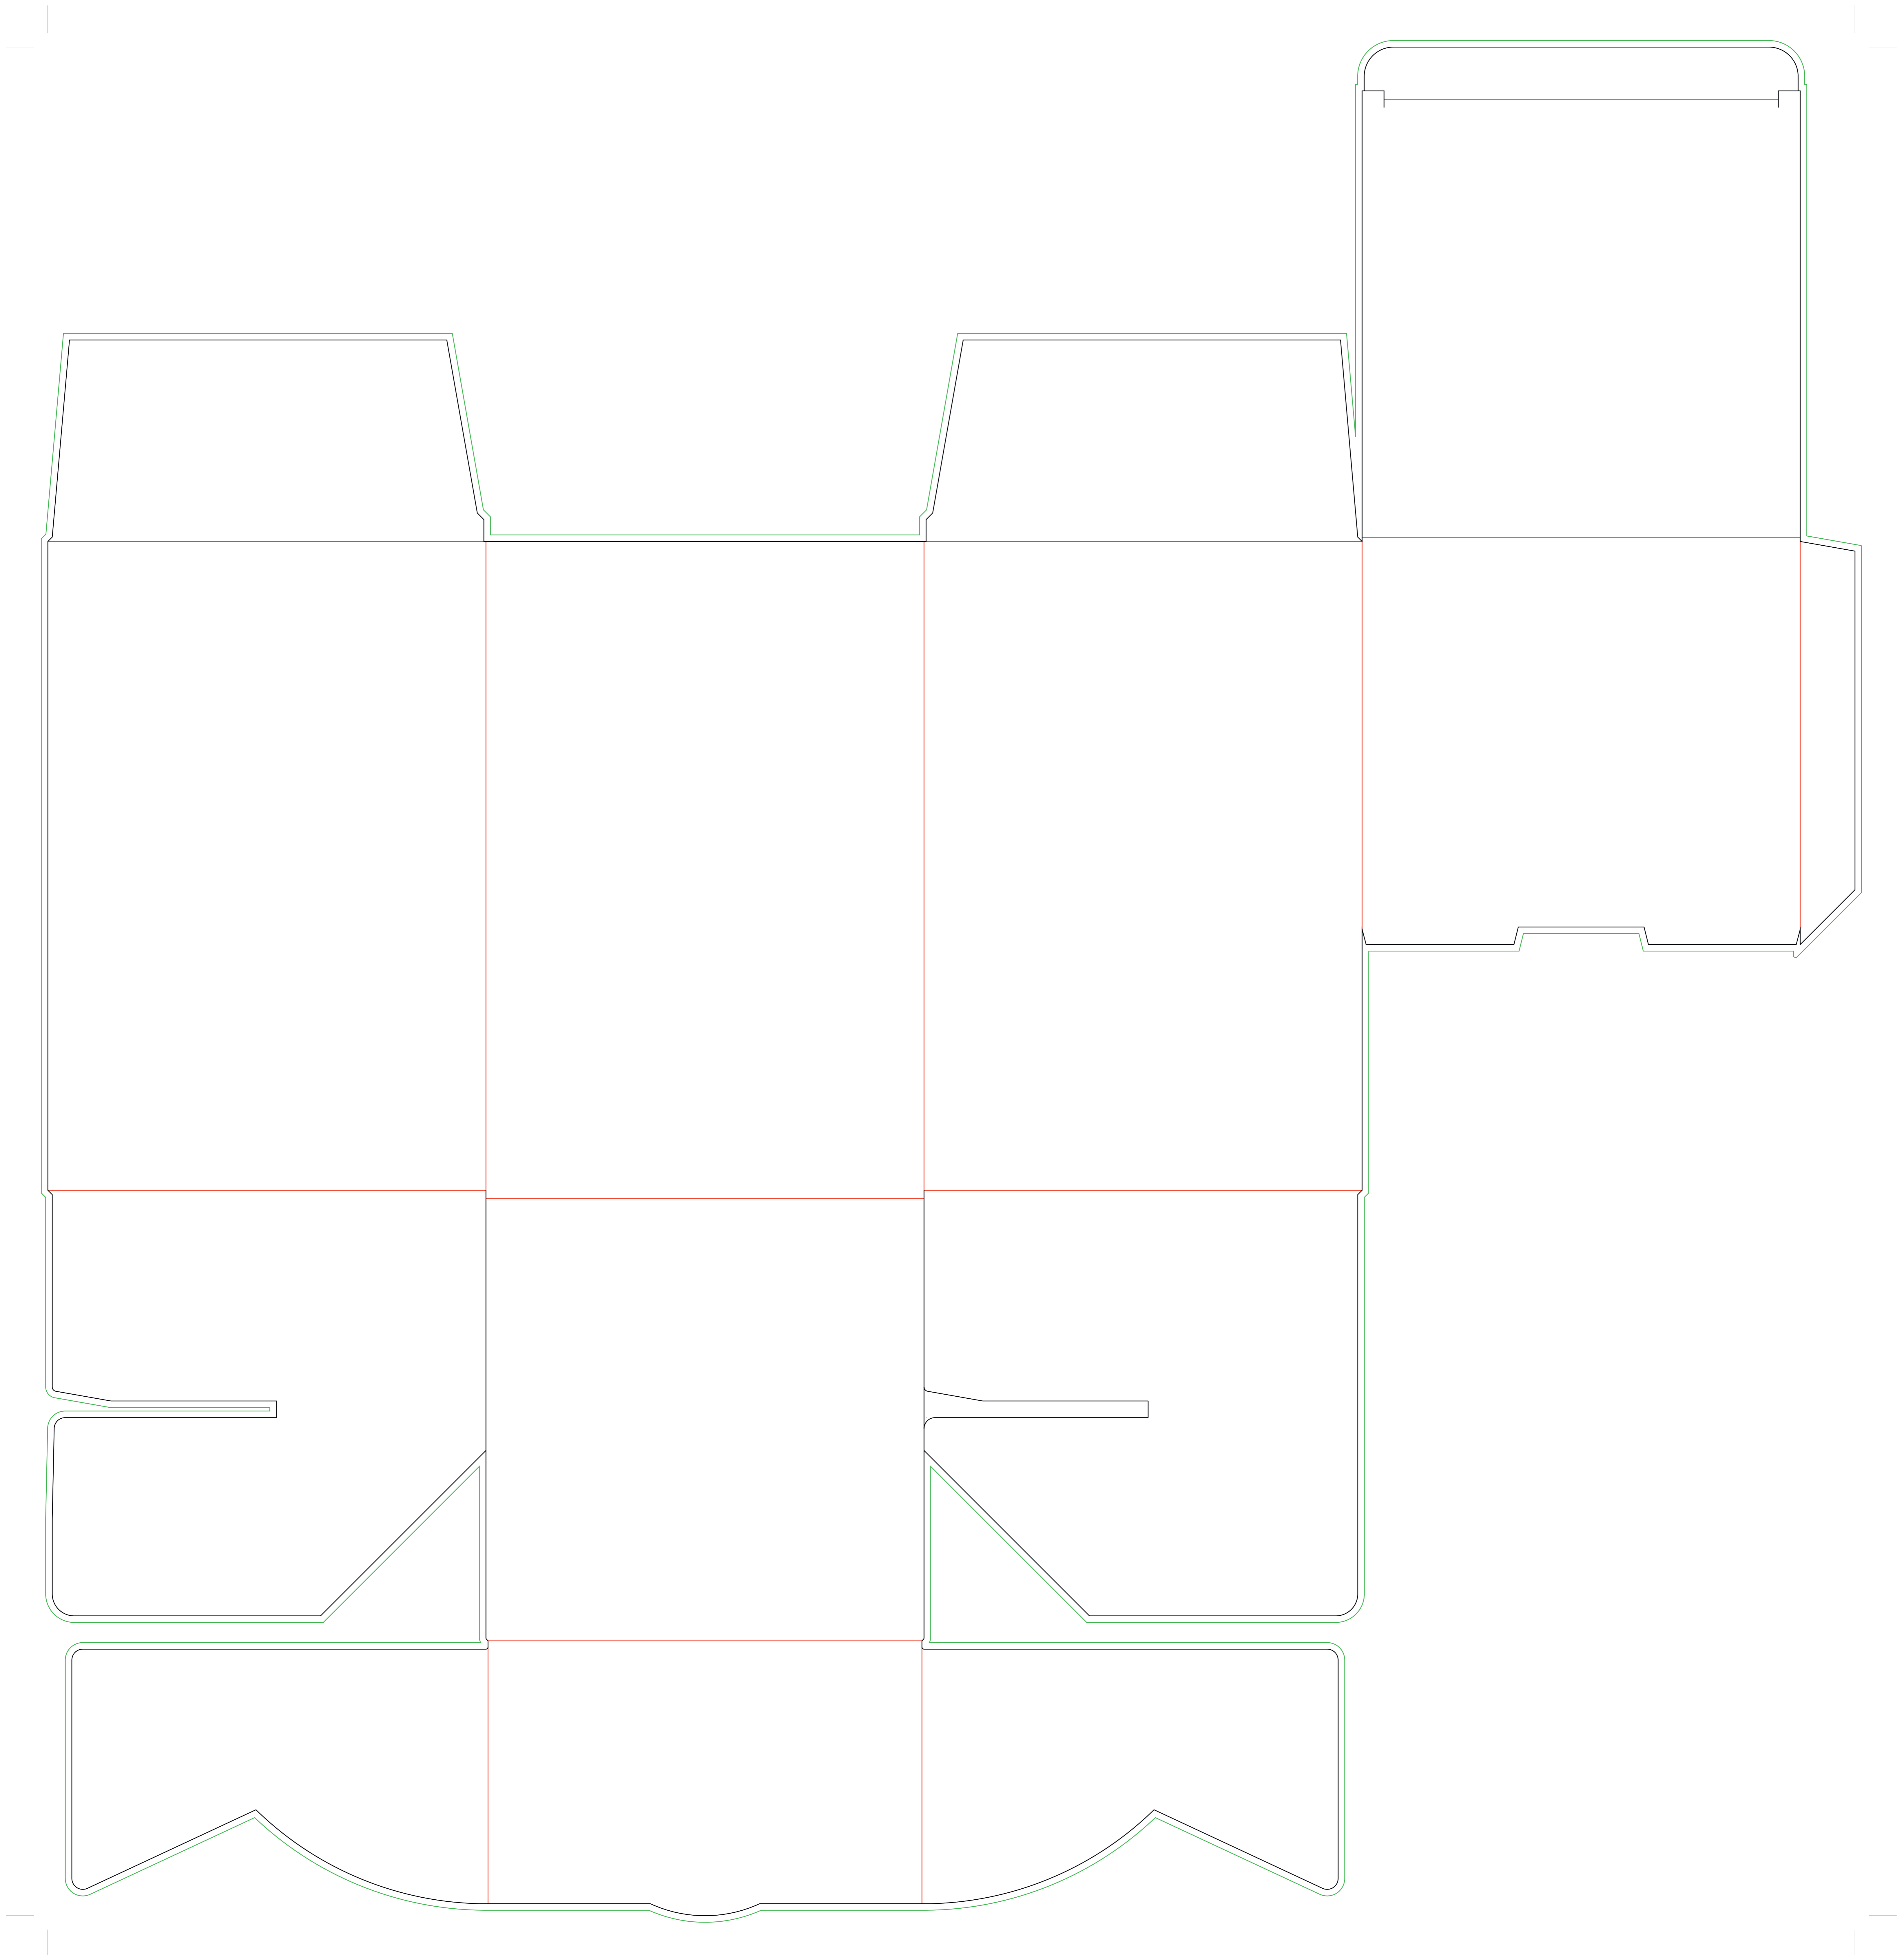EXTERIOR



i Caja dispensadora M

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Hendidos.