



CAJA DISPENSADORA XL

MICROCANAL E



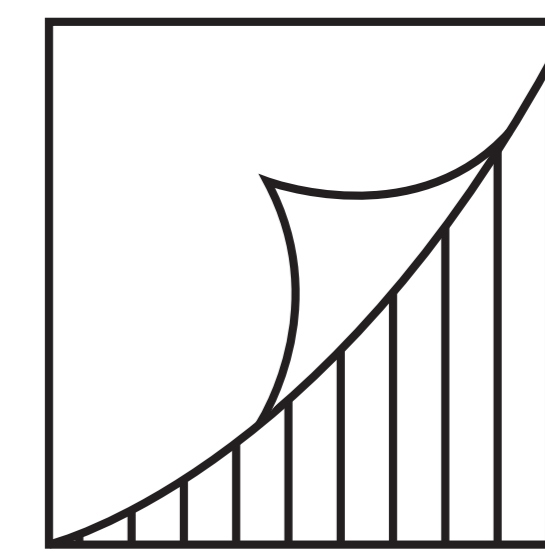


Dirección de canal

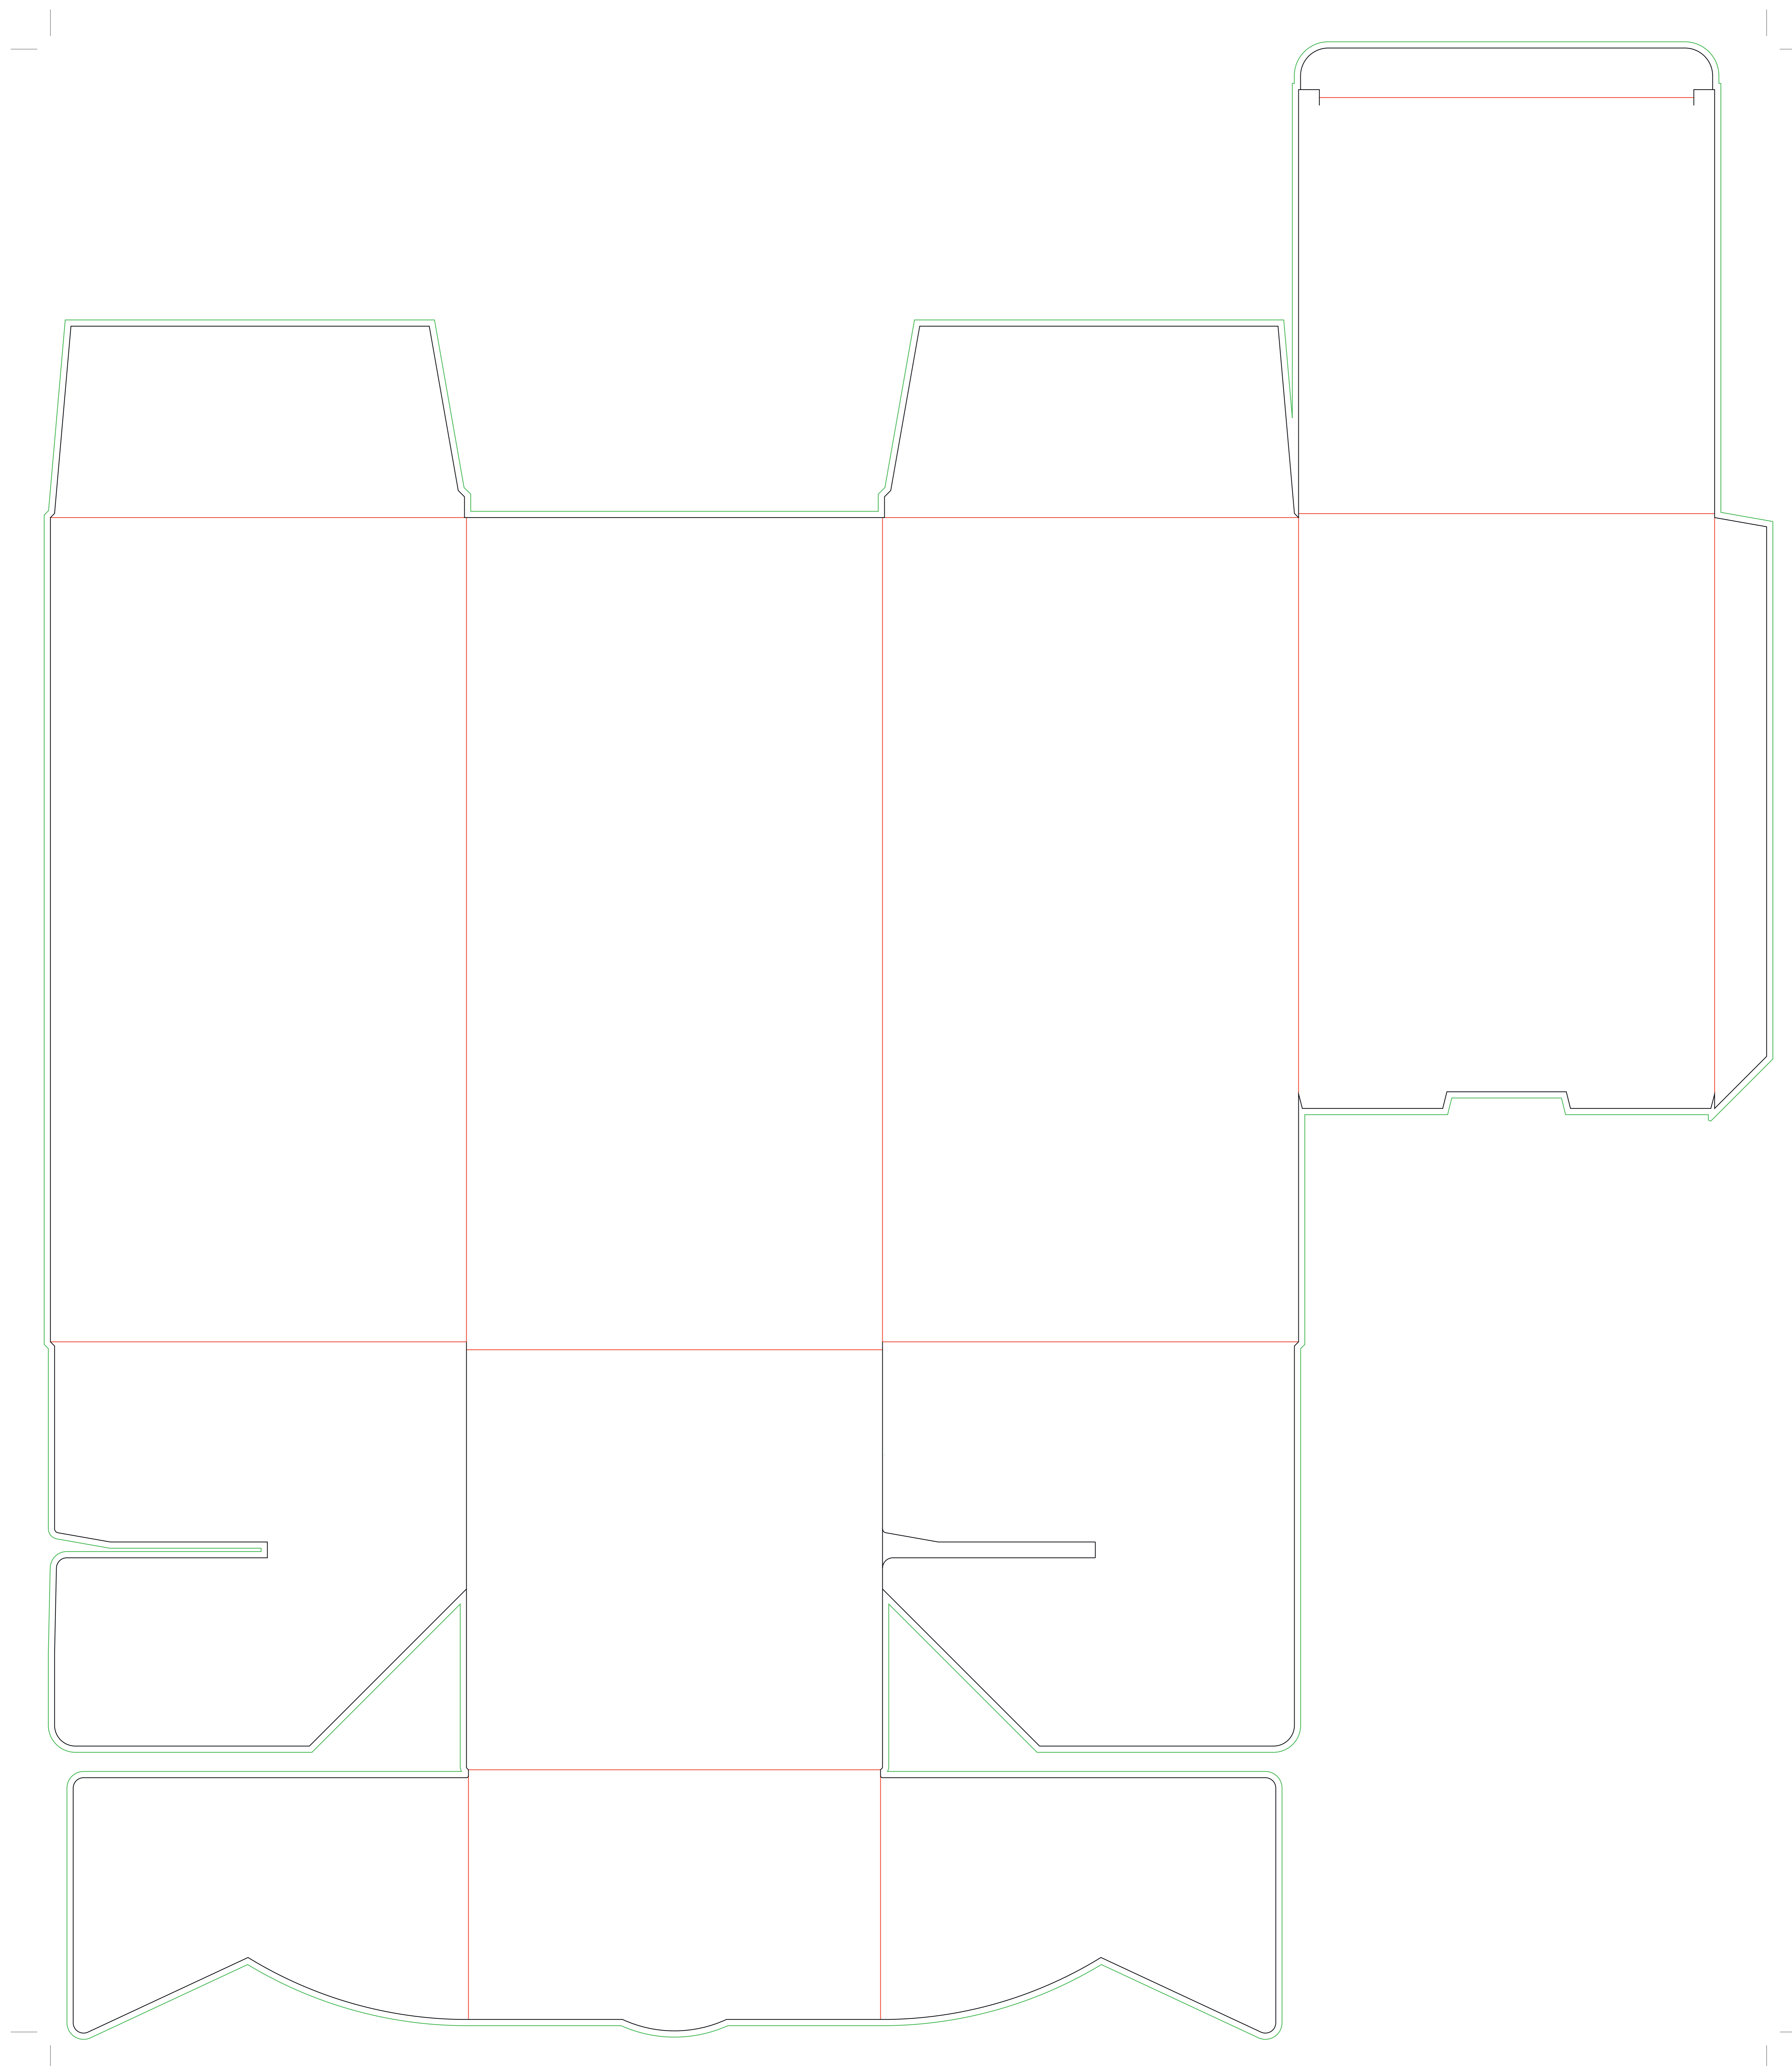EXTERIOR



Caja dispensadora XL

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

-  Sangrado necesario.
-  Zona máxima de diseño.
-  Hendidos.